

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka infuzní techniky - 2015**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Zadavatel v ZD u infuzní pumpy i lineárního dávkovače požaduje:

a) podsvětlenou klávesnici/ovládací tlačítka a další ovládací prvky, bude Zadavatel akceptovat i řešení, které toto podsvícení nemá?

b) možnost blokace ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládní pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves: bude Zadavatel akceptovat místo PINu řešení při vstupu do menu výběru funkce proti neautorizovanému ovládní pacientem?

c) interní paměť na min. 250 léků, bude Zadavatel akceptovat infuzní pumpy, které mají interní paměť na 240 léků a lineární dávkovač, který dle technického listu má interní paměť na 120 léků, ale u každého léku lze definovat až 19 pozic (znaků) a díky neobsazenosti všech těchto znaků se počet možných léků v knihovně navyšuje?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude akceptovat všechna výše uvedená řešení.

Dotaz č.2

Uchazeč:

Zadavatel v ZD u infuzní pumpy požaduje uživatelsky vyměnitelné kapkové čidlo, bude Zadavatel akceptovat přístroj, který touto vlastností není vybaven, z důvodů používání bezpečnostních setů, které dokáží kapky detekovat a proto není potřeba, aby přístroj toto čidlo obsahoval. V případě, že bude Zadavatel toto řešení akceptovat, bude zároveň akceptovat možnost chodu infuzní pumpy i bez kapkového senzoru?

Zadavatel:

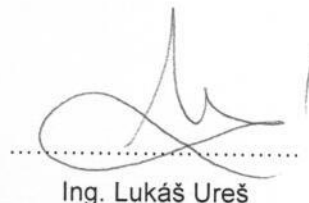
Ano, Zadavatel bude akceptovat i infuzní pumpu konstrukčně řešenou bez kapkového senzoru, pokud je bezpečnost podávání infuze řešena jinými bezpečnostními prvky a výrobce proto infuzní pumpu kapkovým senzorem nevybavil.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 30.7.2015 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 27.7.2015


Ing. Lukáš Ureš