

DODATEČNÉ INFORMACE 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka 2ks dialyzačních monitorů – I.IK**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Ve vymezení předmětu zakázky uvádíte požadavek na vybavení systémem na měření krevní recirkulace v pístěli. Je nesplnění tohoto požadavku důvodem pro vyloučení nabídky z veřejné zakázky?

Zadavatel:

Ano, nesplnění tohoto požadavku zadavatele je důvodem pro vyřazení nabídky z této veřejné zakázky.

Dotaz č.2

Uchazeč:

Je možné splnit požadavek na vybavení 2 ks dialyzačních monitorů systémem na měření krevní recirkulace v pístěli samostatným externím přístrojem? Pokud ano, stačil by jeden kus tohoto přístroje pro splnění požadavku? Externí přístroj lze použít pro kterýkoliv dialyzační monitor.

Zadavatel:

Ano, požadavek na vybavení systémem na měření krevní recirkulace v pístěli lze splnit pomocí samostatného externího přístroje, avšak ke každému dialyzačnímu monitoru po jednom kusu.

Uchazeč musí tuto skutečnost rovněž uvést ve své nabídce, zahrnout dodatečné pořizovací náklady na tyto externí přístroje do výpočtu VNC (výše nabídkové ceny) a současně uvést cenu dodatečného spotřebního materiálu (pokud je k připojení externího přístroje vyžadován).

Dotaz č.3

Uchazeč:

Je možné parametr automatické úpravy ultrafiltrace na základě kontinuálního sledování změn krevního objemu splnit parametrem automatické úpravy ultrafiltrace na základě změn systémového krevního tlaku pacienta?

Zadavatel:

Ne, parametrem automatické úpravy ultrafiltrace na základě změn systémového krevního tlaku pacienta nelze splnit zadavatelem požadovaný parametr úpravy ultrafiltrace na základě kontinuálního sledování změn krevního objemu, nicméně nesplnění tohoto parametru nebude Zadavatelem chápáno jako nenaplnění předmětu plnění a z toho důvodu nebude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení.

Dotaz č.4

Uchazeč:

Je možné měření recirkulace provádět externím přístrojem?

Zadavatel:

Odpověď viz. Dotaz č.2.

Dotaz č.5

Uchazeč:

Je nesplnění parametru plynulý přechod během procedury na jinou léčebnou metodu, např. při hemodialýze přepojit na hemodiafiltraci a naopak, důvodem k vyloučení, ačkoliv tento parametr splňuje pouze jeden typ přístroje?

Zadavatel:

Pro zadavatele není tento parametr nezbytný, lze ho však považovat za výhodu. Zejména s ohledem na uvedenou skutečnost (tento parametr splňuje pouze jeden typ přístroje) nesplnění tohoto parametru nebude Zadavatelem chápáno jako nenaplnění předmětu plnění a z toho důvodu nebude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení.

Dotaz č.6


Uchazeč:

Trvá Zadavatel nadále na požadavku automatické úpravy ultrafiltrace na základě kontinuálního sledování změn krevního objemu jako na nepodkročitelném technickém parametru, jehož nesplnění je důvodem k tomu, aby byla nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení, či nikoliv?

Zadavatel:

Ne, Zadavatel nadále netrvá na požadavku automatické úpravy ultrafiltrace na základě kontinuálního sledování změn krevního objemu jako na nepodkročitelném technickém parametru. Nenaplnění tohoto parametru nebude důvodem k vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.

V Plzni dne 16.10.2012

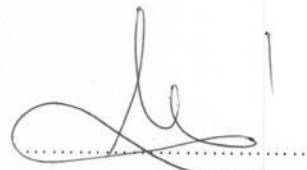

Ing. Lukáš Ureš