

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VZMR:

**Dodávka centrifug - 2016****Dotaz č.1**

Uchazeč:

**2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH**

je uveden požadavek na příslušenství: „6místný výkyvný rotor s univerzálními závěsy, vložky do uni závěsů pro zkumavky o průměru 16 mm a výšky 75 – 100 mm“.

6místný rotor může být specifický pro konkrétního výrobce, většina výrobců používá rotory 4místné. Máme proto následující dotazy:

- 1) Jakou požaduje zadavatel celkovou minimální kapacitu výkyvného rotoru pro v zadání specifikované zkumavky?
- 2) Lze nabídnout 4místný výkyvný rotor s univerzálními závěsy při zachování kapacity dle prvního dotazu?

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na rotor 4 místný, s kapacitou min. 4 x 200 ml.

**Dotaz č.2**

Uchazeč:

Je možné prodloužení lhůty na podání nabídek do pátku 4.11. do 16 hodin ? Vaši výzvu jsme obdrželi e-mailem ve středu 26.10. v 15,10h. Nabídky se mají odevzdat nejpozději ve čtvrtek 3.11. v 9,00 hodin. Je tedy nutné nabídky dopravit již ve středu, žádná pošta negarantuje doručení před devátou ranní. Na osobní doručení před devátou také nelze spoléhat při současné situaci na dálnicích a silnicích. Vzhledem k tomu, že 28.10. je státní svátek, bude tedy na zpracování nabídky čas jen 3 celé pracovní dny a část středy, řekněme tedy 3 a půl dne. Žádáme proto o prodloužení lhůty na podání nabídek alespoň do pátku 4.11. do 16 hodin.

Zadavatel:

V souvislosti s v tomto dokumentu uvedenými odpověďmi Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek – více informací je uvedeno na následující stránce.

**Dotaz č.3**

Uchazeč:

**2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH**

Je možné nabídnout i 4-místný výkyvný rotor 4 x 200 ml ? 6-místný rotor není u centrifug této kategorie obvykle k dispozici. A pokud je, má obvykle menší celkovou kapacitu 6 x 100 ml.

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na rotor 4 místný, s kapacitou min. 4 x 200 ml.

## Dotaz č.4

Uchazeč:

### 2.5. Chlazená centrifuga – 1ks – HOO

Je možné nabídnout i centrifugu, kde je při výměně rotorů nutné použít T klíč ? Jinak by požadavkům vyhověl jediný výrobce Thermo Scientific.

Zadavatel:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku, tj.: snadná výměna rotorů bez nutnosti použití dalších nástrojů. Alternativně lze akceptovat nabídku na centrifugu, u které se mění v rotoru pouze závěsy.

## Dotaz č.5

Uchazeč:

### 2.6. Cytocentrifuga – 1ks – PNE

Je možné nabídnout cytocentrifugu s požadovanou kapacitou a parametry, ale s pamětí 10 protokolů a minimálními otáčkami od 500 RPM ?

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na cytocentrifugu s pamětí na 10 protokolů a více, avšak trvá na požadavku otáček od 200 rpm.

## Dotaz č.6

Uchazeč:

Předpokládaná hodnota zakázky bod 3. Jsou uvedené ceny nepřekročitelné?

Zadavatel:


Zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty jsou odhadem zadavatele a vychází ze zkušeností s nákupem obdobného přístrojového vybavení. Tyto hodnoty však nejsou hodnotami maximálními ani nepřekročitelnými.

## Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 04.11.2016 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 27.10.2016

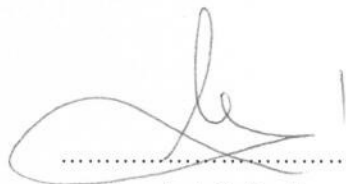

Ing. Lukáš Ureš