

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka přístrojového vybavení pro elektrokoagulaci

Zadavatel:

Zadavatel si dovoluje upozornit uchazeče na opravu ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka přístrojového vybavení pro elektrokoagulaci

Lhůta pro podání nabídek stanovená v této výzvě v bodě 11 je uvedena chybně na **23.9.2011 do 9.00h**. Tento údaj je nesprávný a platný je termín, který je uveden na úvodní straně výzvy tj. **30.9.2011 do 9.00h**.

Dotaz č.1

Uchazeč:

Musí nabízený přístroj nutně splňovat požadavek dostupnosti minimálně třech módů pro bipolární koagulaci?

Z konzultace s primáři oddělení a z probíhající zápůjčky vím, že vůbec bipolární koagulaci nepoužívají!

Přístroj, který splňuje uvedený požadavek třech módů pro bipolární koagulaci je podstatně dražší a značně navyšuje cenu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který má pouze jeden mód bipolární koagulace?

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, který má pouze jeden mód bipolární koagulace.

Dotaz č.2

Uchazeč:

Je přístroj dle specifikace „2.3. 1x přístroj – oddělení KOTPÚ“ požadován včetně jednotky pro argon plazmovou koagulaci, nebo má mít pouze možnost jejího připojení v budoucnu?

Zadavatel:

Zadavatel požaduje přístroj včetně jednotky pro argon plazmovou koagulaci.

Dotaz č.3

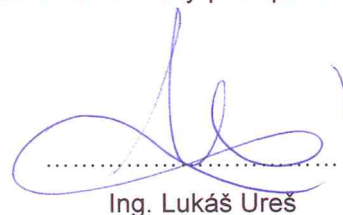
Uchazeč:

Jaké příslušenství je k přístrojům požadováno. Zda-li je to jen pedál, nebo pedál se základním monopolárním a bipolárním příslušenstvím, jako u běžných výběrových řízení.?

Zadavatel:

Zadavatel požaduje základní příslušenství pro otevřenou operativu pro monopolární, bipolární i arg.koagulaci vč. nožního pedálu (tj. neutrální elektroda a ručka+hroty pro opakované použití) a min.10ks jednorázových neutrálních elektrod.

V Plzni dne 27.9.2011


Ing. Lukáš Uřeš